

Объявление № 20 от 07.12.2020 года


О проведении закупа способом запроса ценовых предложений

Основание: пункт 105 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

Перечень товаров:

№	Наименование товара	ед.изм.	кол-во	цена
1	Лампа операционная бестеневая	шт	1	524 920,00

- 1. Наименование и адрес заказчик (организатора) закупа:** КГП «Карасуская районная больница» УзаКо (далее Больница), 111000, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу улица Т.Рамазанова, 2.
- 2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее – товары), объем закупа сумма, выделенная для закупа по каждому-товару;**
- 3. Место поставки:** 111000, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, улица Т.Рамазанова, 2.
- 4. Сроки и условия поставки:** Поставка осуществляется за счет Поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе по заявке Заказчика в течении 2020 года.
- 5. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** 111000, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, улица Т.Рамазанова, 2, административный корпус 2 этаж, Бухгалтерия, время с 9.00 до 14.00 по 14 декабря 2020 года включительно до 11.00 часов.
- 6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 14 декабря 2020 года, время 12.00 часов 111000, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, улица Т.Рамазанова, 2, административный корпус 2 этаж, Бухгалтерия.
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение; подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также

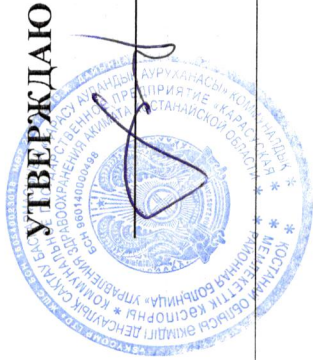

Голубев В.В.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание	Требуемое количество о (с указанием единицы измерения)
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания	Лампа операционная бестеневая	<p>№ п/п</p> <p>Наименование комплектующего</p> <p>Краткая техническая характеристика</p>
2	Требования к комплектации	<p>Основные комплектующие</p> <p>Лампа операционная бестеневая</p>	<p>Лампа операционная бестеневая должна состоять из комбинации галогеновых ламп и многослойных фильтров и представлять освещение яркостью до 30 000 Люкс, при цветовой температуре 3800 К.</p> <p>Для минимизации возрастания температуры системы освещения в ходе эксплуатации должно использоваться многолучевой рефлектор и стекло, отфильтровывающее инфракрасное излучение.</p> <p>Не менее 1 шт.</p>

			<p>Нагрев воздуха в области головы хирурга должен быть минимален. Для установки в нужное положение должно использоваться специальное гибкое плечо и регулируемая по высоте стойка. Габариты до Ш 440 мм х В 1250-1850 мм х Д 440 мм Диапазон регулировки высоты 1250 - 1850 мм Диаметр светильника не менее 190 мм Источник питания АС 110 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность до 50 Вт Продолжительность эксплуатации не менее 1999 ч Вращение: не менее 360° Рефлектор: многолучевой рефлектор Лампа галогенная 24 В, 50 Вт</p>	1 шт.
<i>Дополнительные комплектующие</i>				
2	Корпус лампы	Лампа и рефлектор закреплены внутри корпуса лампы, материал которого превосходно отводит тепло		1 шт.
3	Ручка	Ручка для позиционирования светильника, управляет углом освещения и положением лампы		1 шт.
4	Гибкое плечо	Изготовлено из гибкого шланга, таким образом, регулирует угол наклона плафона и направление освещения		1 шт.
5	Стойка	Поддерживает корпус лампы и позволяет регулировать высоту светильника		1 шт.
6	Основание	Является центром тяжести светильника, на дне обеспечивает устойчивость, на дне основания закреплен трансформатор		1 шт.

		7 Ролики	Двухдюймовые ролики обеспечивают перемещение аппарата	4 шт.
		8 Фронтальное стекло	Блокирует ультрафиолетовое излучение от света через рассеянное отражение	1 шт.
		9 Соединитель	Выступает в качестве внешнего источника питания для лампы	1 шт.
		10 Переключатель питания	Предназначен для подключения источника питания лампы	1 шт.
3	Условия осуществления поставки	DDP, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, Рамазанова, 2		
4	Срок поставки и место дислокации	15 календарных дней Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, Рамазанова, 2		
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 		